

Douche

Crystal



Chariots de douche à hauteur variable

REF. 3700.00 - 3701.00 - 3800.00 - 3800.20 - 3801.00 - 3802.00 - 3802.01 - 3860.00 - 3860.20 - 3861.00 - 3862.00 - 3865.00 - 3866.00

Des chariots de douche associant vitesse et silence, équipé d'un matelas conçu pour un nettoyage optimal et d'un oreiller mobile : confort, hygiène et sécurité sont au rendez-vous des soins et de la toilette.



Modèle
3860.00

FABRICATION
FRANÇAISE
DEPUIS 1976

REVAL
LE BIEN-ÊTRE DURABLE

Douche

Crystal

POINTS FORTS




Option 3860.91



- Le confort du patient est assuré par la texture du matelas.
- L'oreiller triangulaire mobile s'adapte à toutes les positions.
- Les ridelles latérales en acier inoxydable assurent la totale sécurité du patient.
- Existe en version électrique ou hydraulique, en version standard, allongée, en modèle enfant ou pour patient obèse.




Option 3802.10



Chariots de douche à hauteur variable

REF. 3700.00 - 3701.00 - 3800.00 - 3800.20 - 3801.00 - 3802.00 - 3802.01 - 3860.00 - 3860.20 - 3861.00 - 3862.00 - 3865.00 - 3866.00

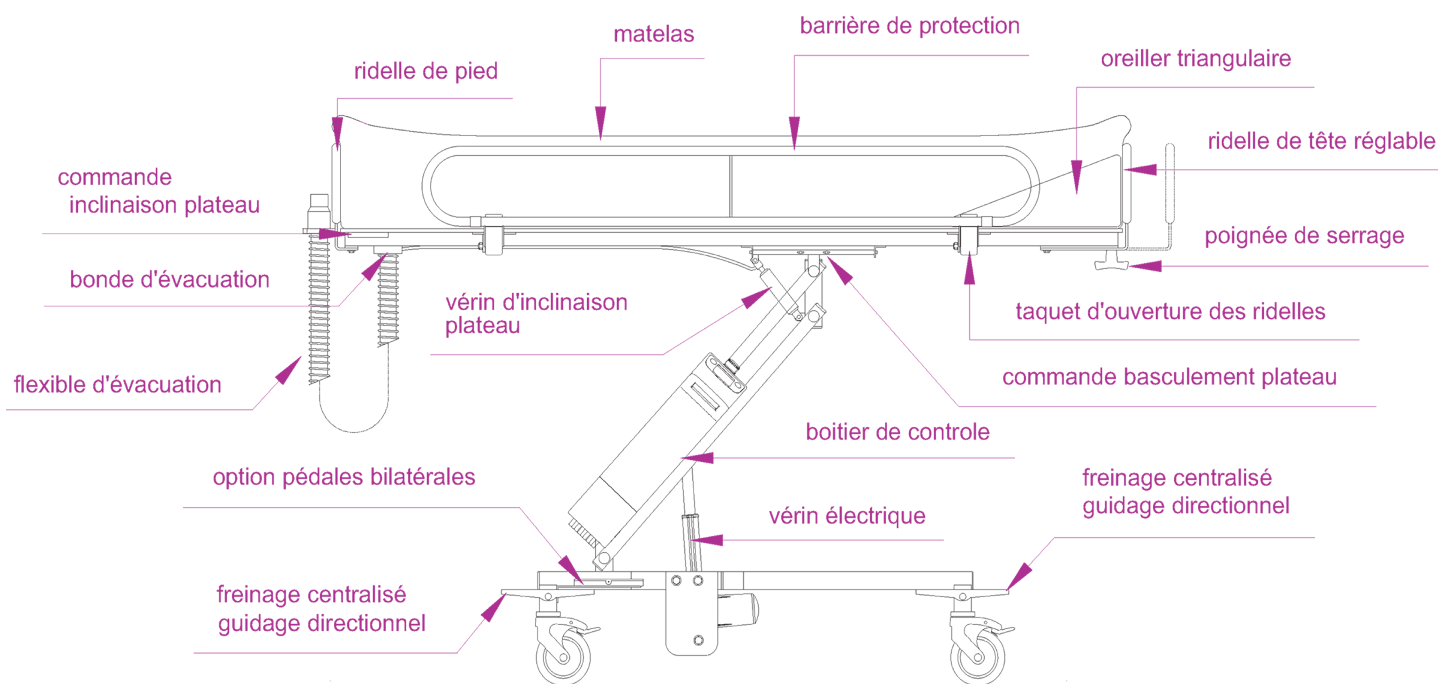

**FABRICATION
FRANÇAISE**

DEPUIS 1976

Douche

Crystal




Pupitre 3011.01



Pupitre 3012.01

Chariots de douche à hauteur variable

REF. 3700.00 - 3701.00 - 3800.00 - 3800.20 - 3801.00 - 3802.00 - 3802.01 - 3860.00 - 3860.20 - 3861.00 - 3862.00 - 3865.00 - 3866.00

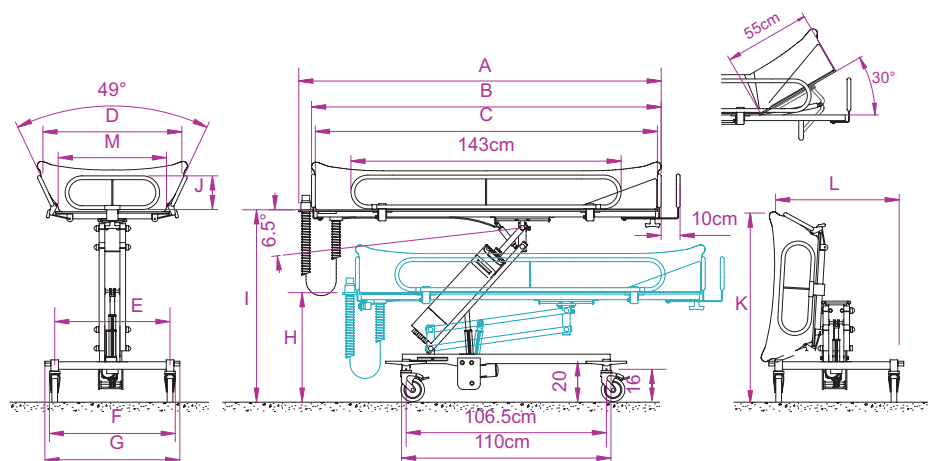

DESCRIPTIF : (suivant modèles)

Structure

- Structure en acier traité anti-corrosion avec revêtement peinture Epoxy.
- 4 roulettes Ø100mm avec freins.
- Freinage bi-centralisé.
- Guidage directionnel bi-centralisé.
- Vérin hydraulique de hauteur variable avec commande bilatérale au pied ou vérin électrique 24V avec télécommande 2 fonctions.

Plateau

- Plateau en Polypropylène (incassable).
- Plateau à basculement latéral pour rangement ou nettoyage.
- Fonction Procline/Décline par vérin à gaz avec commande manuelle.
- Fonction Relève-buste progressif réglable de 0 à 30° par vérin à gaz. (sur modèle 3802.01 uniquement)
- Barrières latérales en acier inoxydable articulées avec fermetures automatiques de sécurité.
- Ridelle de pieds en acier inoxydable.
- Ridelle de tête en acier inoxydable réglable.
- Protections de plateau sur les coins.

Matelas

- Matelas à usage intensif, étanche, en PVC souple.
- Ecoulement central côté pieds.
- Evacuation par tuyau flexible Ø40mm.
- Oreiller triangulaire.

Conformité:

- 93/42/CEE (Directive Dispositifs Médicaux)
- 2014/35/UE (Matériel électrique Basse Tension)
- 2014/30/UE (Compatibilité électromagnétique)
- NF EN 12182 (Aides techniques pour personnes handicapées)
- NF EN ISO 14971 (Gestion des risques des dispositifs médicaux)

Options:

- 3802.10 Relève-buste multi-positions.
- 3860.91 Commandes au pieds pour Crystal électrique.
- 3860.93 Batterie 24V supplémentaire.
- 3700.80 Tige porte-sérum.

